GABRIEL BENMAYOR S.A
C/Bach, 2-B Pol. Ind. Foinvasa
08110 Montcada i Reixac
BARCELONA (SPAIN)

LÁMPARA DE BLANQUEAMIENTO TECHNOFLUX MOD. M-87 CON SOPORTE Y BARRA – ESN003700

Manual de instalación y uso

(M-87)

GABRIEL BENMAYOR S.A
C/Bach, 2-B Pol. Ind. Foinvasa
08110 Montcada i Reixac
BARCELONA (SPAIN)

Catálogo

1.- Seguridad ……..……3

2.- Imágenes de instrucción de montaje ……4

3.- Características del producto ……..……5

4.- Especificaciones del producto ……...……6

5.- Contenido ……...……7

6.- Funcionamiento ……..……7

GABRIEL BENMAYOR S.A
C/Bach, 2-B Pol. Ind. Foinvasa
08110 Montcada i Reixac
BARCELONA (SPAIN)

SEGURIDAD

NOTA :

Antes de la instalación e inicio de la unidad, leer las instrucciones con atención. Como sucede con cualquier sistema técnico, el funcionamiento adecuado y seguro de la unidad depende de la competencia del usuario.

▲**PRECAUCIÓN** : Es importante seguir las precauciones. No enfocar la luz directamente o hacia partes de la encía desprotegidas o piel.

▲**PRECAUCIÓN** : Personas con un historial de fotosensibilidad o que usen medicamentos de fotosensibilidad no deben estar expuestas a la luz de esta unidad.

▲**PRECAUCIÓN** : Este equipo no se puede usar en presencia de mezclas anestésicas inflamables con aire u óxido nitroso

▲**PRECAUCIÓN** :No mirar a la luz emitida por la máquina durante su uso, puede provocar daño ocular, es necesario llevar gafas.

▲**PRECAUCIÓN** : El ángulo de uso no puede supercar los 90º, puede romperse con facilidad o provocar ruido en el futuro.

GABRIEL BENMAYOR S.A
C/Bach, 2-B Pol. Ind. Foinvasa
08110 Montcada i Reixac
BARCELONA (SPAIN)

Imágenes de instrucción de montaje

Advertencia : Cuando el tornillo está flojo, los muelles saltarán con facilidad.

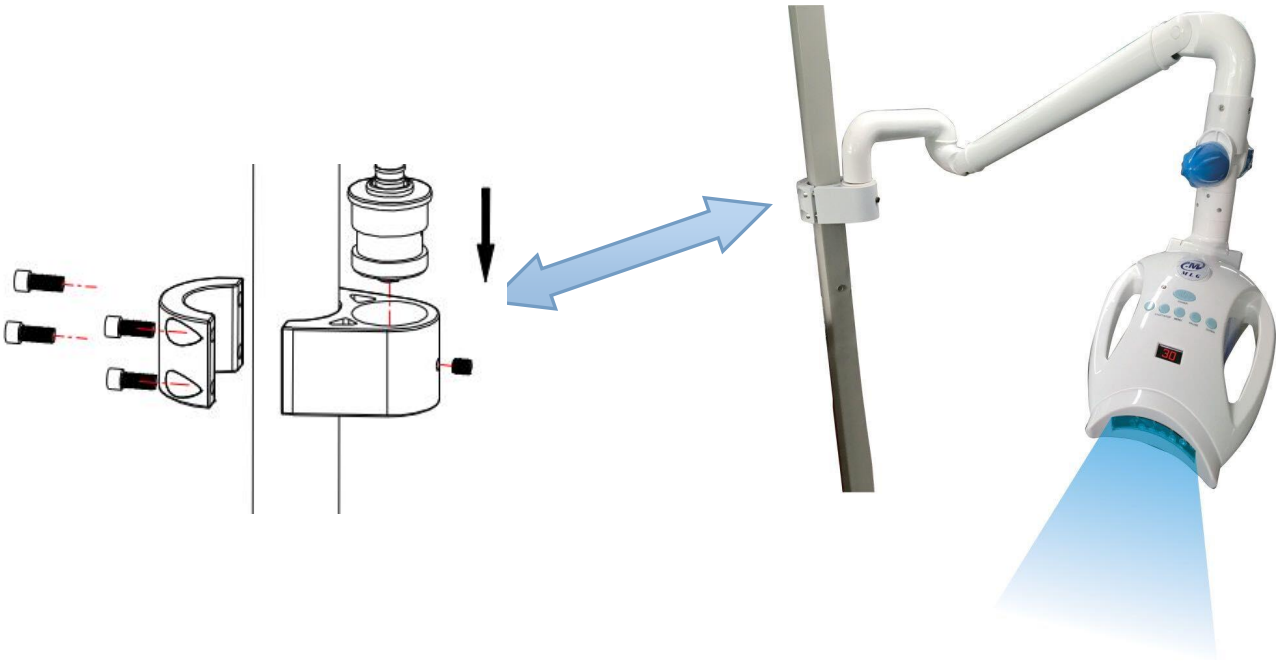

GABRIEL BENMAYOR S.A
C/Bach, 2-B Pol. Ind. Foinvasa
08110 Montcada i Reixac
BARCELONA (SPAIN)

Manual de botón de usuario

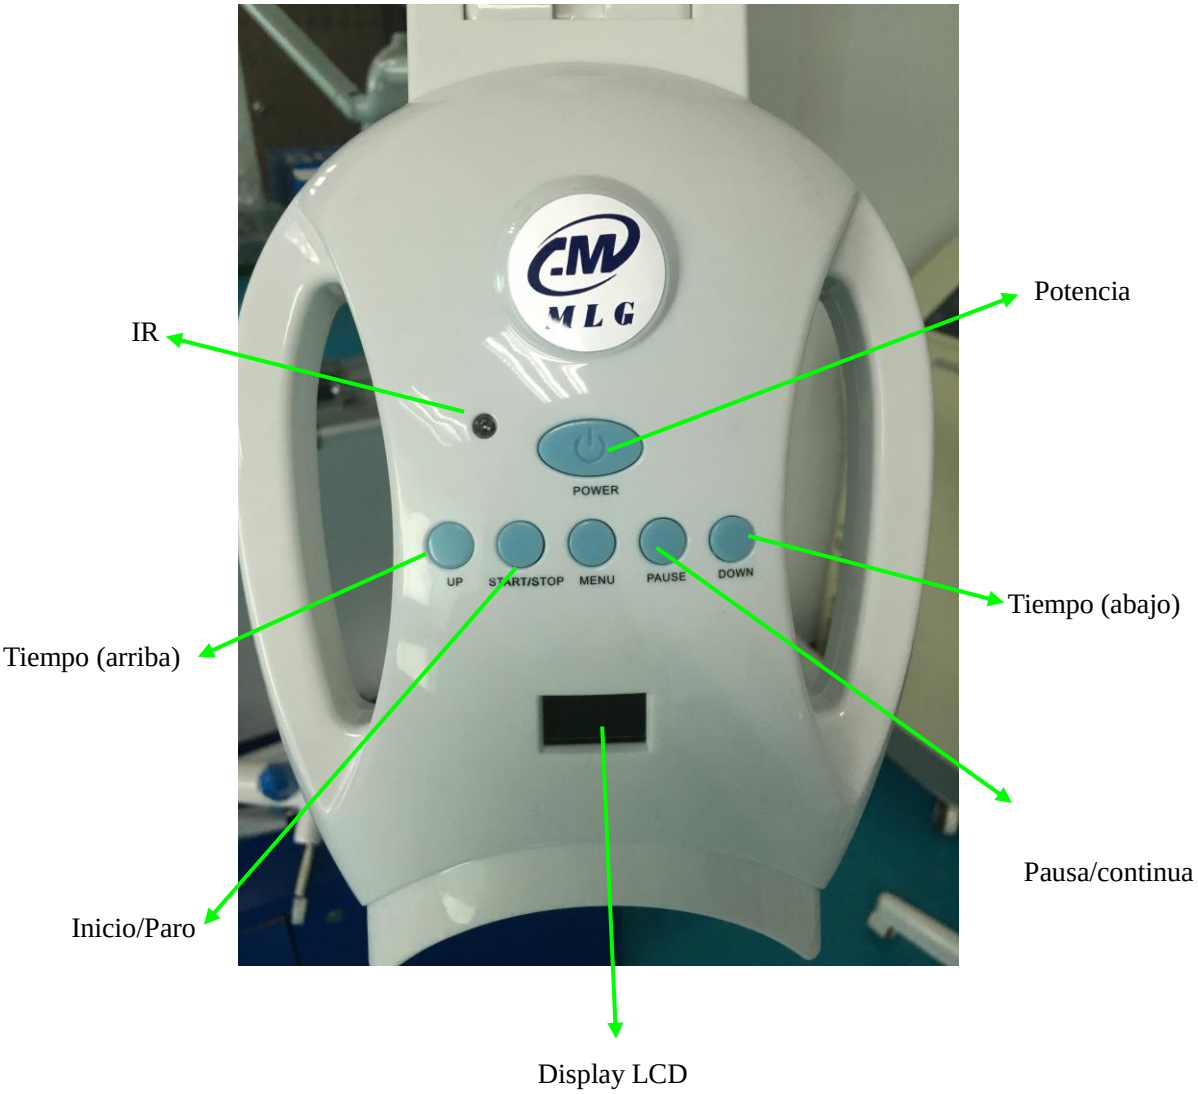

Manual control remote

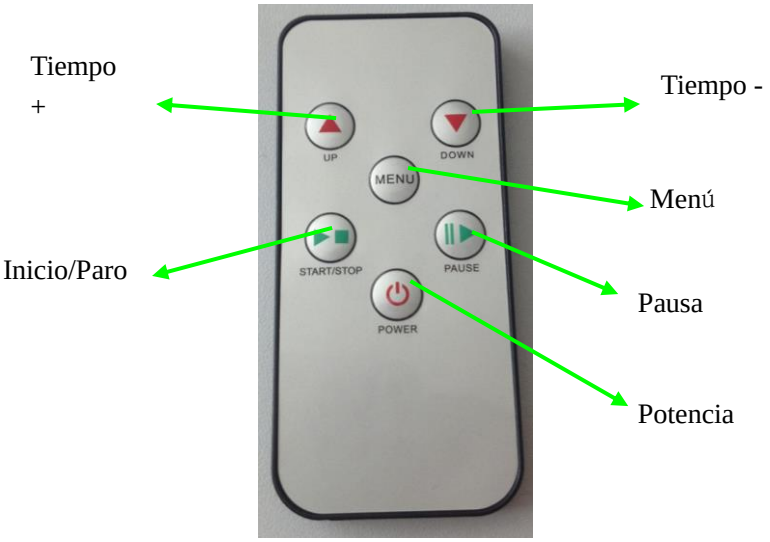

Este menú admite dos lenguas : chino e inglés. Pulsar el botón "menu" largo tiempo, usar "arriba" y "abajo" para moverse, volver a pulsar "menu".

Características del producto

- Combinación de 5 piezas de LED azul alta potencia, 2 piezas de LED rojo alta potencia y 8 de púrpura. La luz púrpura tiene el efecto de esterilización.
- El tiempo de blanqueamiento se puede seleccionar con un temporizador controlado por micro-procesador.
- Indicador digital con feedback de audio.
- Potencia auto-selectiva : 100~240V 50/60 Hz para uso global.
- Sistema de blanqueamiento de dientes multi-arco de alta velocidad.
- Diseño de base pequeña, uso adecuado para clínica dental.
- Uniformidad en la emission de luz.
- Función de control remote con infra-rojos de alta sensibilidad.

Especificaciones del producto

- Ancho espectro : Azul :420nm~472.5nm(Lámparas) rojo :610nm~650nm.
- Salida potencia luz : Hasta 2327 mW/cm
- 100-240V,50/60Hz
- Peso 5.2 Kgs.
- Max. radio de trabajo :50cm

- Uniformidad en la emision de luz :
-

Distancia entre los dientes y el iluminador (mm)	Uniformidad
1mm	Superior a 80%
3mm	Superior a 80%
5mm	Superior a 80%
10mm	Superior a 80%

Contenido

M-87	1 pieza
Base metálica	1 set
12V adaptador	1 pieza
Cable potencia	1 pieza
Cristal	2 piezas
Sombra lámpara	5 piezas
Control remote	1 pieza
Boca	1 pieza
Herramienta montaje	1 set
Disco con manual	1 pieza

Funcionamiento

Encender el acelerador para blanqueamiento de dientes

A) Enchufe en el acelerador de blanqueamiento de dientes.
B) Encender el interruptor de potencia

Advertencia .

Incluye un fusible de seguridad. Si hay sobre-corriente, se cortará de inmediato. Cuando se ponga un nuevo fusible, el trabajo volverá a la normalidad.

Usando el acelerador de blanqueamiento de dientes

A) Pulsar el botón de potencia. El sistema se pondrá en marcha.

B) Pulsar “menu” para establecer tiempo, brillo y LED. Usar Arriba y Abajo para ajustar tiempo, brillo y LED. El tiempo más largo en el proceso de blanqueamiento es de 30 minutos cada ciclo.

Nota : Establecer LED con rojo, azul, rojo+azul.

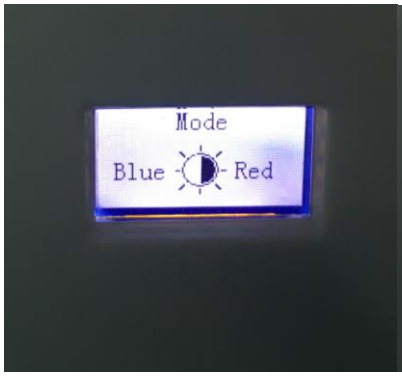

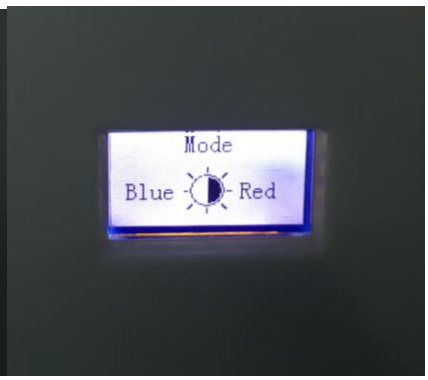

Rojo Rojo+Azul Azul

C) Encender y apagar la luz pulsando el botón de INICIO/PARO.

D) : Parar el tiempo contando y emitiendo luz pulsando el botón de Pausa. El tiempo de blanqueamiento restante se mostrará en el indicador digital. Pulsar el botón de Pausa de nuevo, emitirá luz y el tiempo se contará de manera continuada.

E/ La fecha de la pantalla se muestra de manera sincronizada.

1.Advertencia sonido :

A) Después del inicio, la máquina emitirá un zumbido a cada minuto.

B) Se podrán escuchar tres zumbidos después de acabar.

2. Refrigeración :

A) Para garantizar que todos los leds trabajen a la misma temperature durante el proceso de blanqueamiento, incluimos un ventilador de alta eficacia para expulsar cualquier suciedad.

B) Aparte de esto, incorporamos una protección de temperatura. Cuando se llegue a alta temperatura, la potencia se apagará de manera automática. Después de refrigerarse, se puede volver a trabajar con normalidad.

3. Responsabilidad :

Somos responsables de la seguridad y funcionamiento de la unidad, siempre que :

A) La instalación eléctrica y el espacio sean los adecuados.

B) El equipo se use según las indicaciones del presente manual.

FABRICADO POR:

CHUAN FU MEDICAL INSTRUMENT CO, LTD
IF.,NO.10 LANE 13 MINGDE
TAOYUAN CITY 330 TAIWAN

DISTRIBUIDOR:

GABRIEL BENMAYOR S.A. / C.I.F A-60512100
C/Bach 2-B Pol. Industrial Foinvasa /
08110 Montcada i Reixac (Barcelona) SPAIN
T +34 93 572 41 61 / F +34 93 572 41 65 / www.benmayor.com